

お得意先各位

ニュートリー株式会社

「EJ 連結チューブⅡ」各種 製品パッケージ、単位箱及び外装段ボール箱変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2022年12月より販売を開始いたしました「EJ 連結チューブⅡ」各種につきまして、製品パッケージ、単位箱及び外装段ボール箱の変更を行うこととなりました。詳細を下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 製品名

EJ 連結チューブⅡ チューブ長:30cm (商品コード:A60300)

EJ 連結チューブⅡ チューブ長:60cm (商品コード:A60301)

2. 変更点

製品パッケージ、単位箱及び外装段ボール箱デザイン


3. 主な変更点

●製品パッケージ表示 (チューブ長:30cm、60cm共通)

	現行	変更後
前面		
背面		


1. 社名ロゴを変更
2. 販売業者を変更

● 単位箱表示 (例: チューブ長: 30cm)

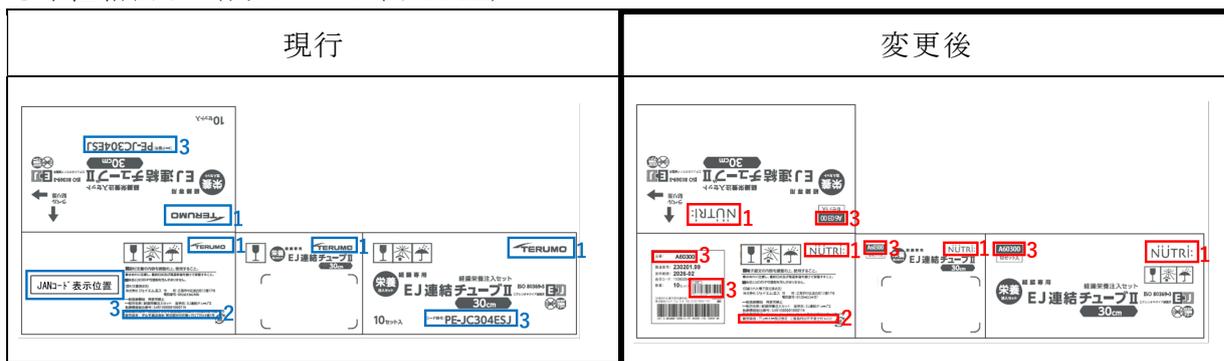

1. 社名ロゴを変更
2. 販売業者を変更
3. 商品コード、JANコードを変更※

● 外装段ボール箱表示 (チューブ長: 30cm、60cm 共通)

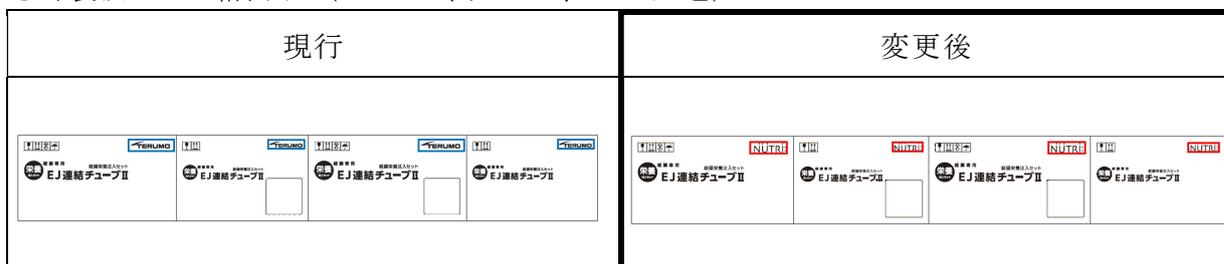

社名ロゴを変更

※以下のコードへ変更となります。

	現行 (テルモ社コード)		変更後	
	商品コード	JANコード	商品コード	JANコード
チューブ長: 30cm	PE-JC304ESJ	単位箱 (10本) 4987892 135101	A60300	単位箱 (10本) 4934989 135094
チューブ長: 60cm	PE-JC604ESJ	単位箱 (10本) 4987892 135118	A60301	単位箱 (10本) 4934989 135131

4. 変更品初回製造番号、使用期限

	製造番号	使用期限
チューブ長: 30cm	230220.61	2026年2月
チューブ長: 60cm	230221.61	2026年2月

5. 変更品弊社出荷時期

チューブ長: 30cm	2023年4月下旬
チューブ長: 60cm	2023年6月中旬

※現行品の在庫がなくなり次第、順次変更品を出荷いたします。

※ご注文状況により多少前後する可能性があります。予めご了承ください。

6. 備考

医療機器届出番号、医療機器クラス分類、規格、サイズ等に変更はございません。

以上

<お問い合わせ先>
ニュートリー株式会社 / TEL: 0120-219-038
 営業時間: 9:00~17:00 (土日・祝日・年末年始・お盆を除く)
 E-mail: info@nutri.co.jp URL: https://www.nutri.co.jp