

お得意先各位

ニュートリー株式会社

## 「PG 加圧バッグ Q」 製品本体及び製品パッケージ表示変更のご案内

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


この度、2022年12月より販売を開始いたしました「PG 加圧バッグ Q」につきまして、製品本体及び製品パッケージの表示変更を行うこととなりました。詳細を下記の通りご案内申し上げます。

今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

- 製品名  
PG 加圧バッグ Q (商品コード:A60303)
- 変更点  
製品本体及び製品パッケージ表示  
発売元
- 主な変更点  
●製品本体表示 (一部拡大)

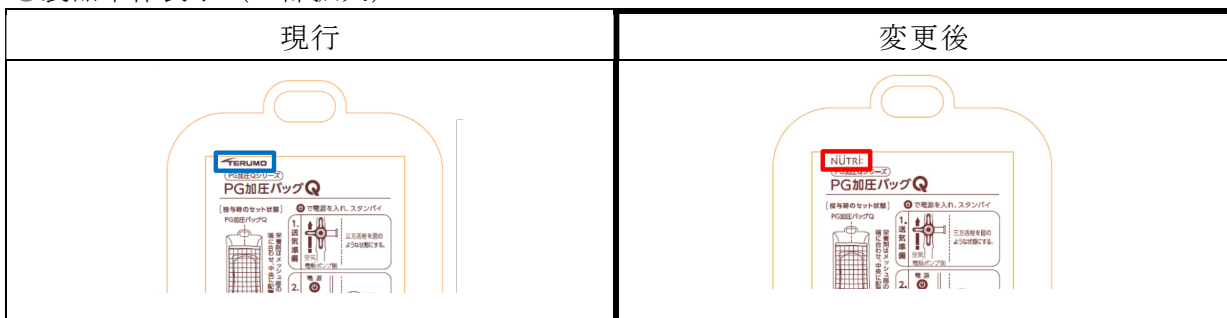

社名ロゴを変更

## ●製品パッケージ表示

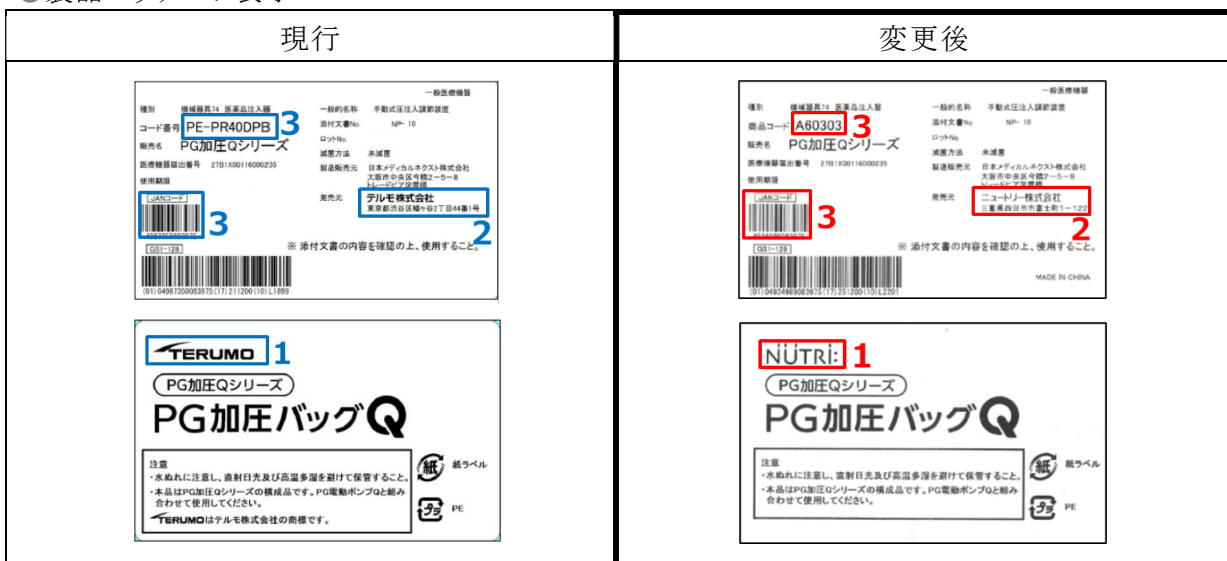

- 社名ロゴを変更
- 発売元を変更
- 商品コード、JANコードを変更※

4. 各種コード ※以下のコードへ変更となります。

現行(テルモ社コード)			変更後		
商品コード		JANコード	商品コード		JANコード
PE-PR40DPB	セット	4987350 083975	A60303	セット	4934989 083975

5. 発売元

現行	変更後
テルモ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号	ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町1-122

6. 変更品初回ロットNo.、使用期限

ロットNo.	使用期限
K2301	2026年11月

7. 変更品弊社出荷時期

2024年4月上旬頃

8. 備考

医療機器届出番号、医療機器クラス分類、規格、サイズ等に変更はございません。

以上

<お問い合わせ先>

**ニュートリー株式会社** / TEL: 0120-219-038

営業時間: 9:00~17:00(土日・祝日・年末年始・お盆を除く)

E-mail: info@nutri.co.jp URL: <https://www.nutri.co.jp>